

مجله علوم و صنایع غذایی ایران

سایت مجله: www.fsct.modares.ac.ir



مقاله علمی-پژوهشی

تشخیص روغن زیتون آلوده به فلزات سنگین توسط سامانه سه الکترودی مبتنی بر ولتاوتمتری چرخه ای

حسن کیانی^۱، بابک بهشتی^{۲*}، علی محمد برقیعی^۳، محمد هاشم رحمتی^۴

۱- دانشجوی دکتری، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

۲- استادیار، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

۳- استاد تمام، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

۴- دانشیار، دانشکده مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

چکیده

اطلاعات مقاله

سیستم‌های سه الکترودی، سیستم چشایی زبان انسان را شبیه سازی کرده و می‌تواند جهت بررسی کیفیت مواد غذایی استفاده گردد. حس چشایی یکی از حواس پنجگانه است و زبان مولکول‌های خاصی را شناسایی می‌کند. در سال‌های اخیر از سیستم‌های سه الکترودی با آرایه‌ای از الکتروودها جهت شناسایی مولکول‌های مختلف استفاده می‌شود. در این تحقیق از یک سامانه سه الکترودی مبتنی بر روش‌های ولتاوتمتری با سه الکترود گرافیت (Pencil Graphite)، صفحه چاپی (Screen Printed (SP)) و گلسی کربن (GC) استفاده شده است.

جهت شناسایی فلزات سنگین (کادمیم، سرب، قلع و نیکل) در روغن خوراکی زیتون استفاده گردید. فلزات سنگین در سه غلظت $0/05$ ، $0/1$ و $0/25$ ppm به روغن خوراکی افزوده شده و سپس خروجی دستگاه توسط روش کمومتریک طبقه بندی شد. بر اساس نتایج PCA، الکتروود PG ۹۶٪ واریانس بین داده‌ها در روغن‌های خوراکی زیتون را شامل می‌شود. همچنین الکتروود SP ۹۱٪ و GC نیز ۱۰۰٪ واریانس بین داده‌ها را در روغن زیتون را شناسایی نموده است. در ادامه روش SVM نیز توانایی بالایی در طبقه بندی فلزات سنگین در روغن‌های خوراکی از خود نشان داده است. همچنین روش PLS توانست ۹۹٪ داده‌ها در روغن زیتون را پیش‌بینی نماید. در نهایت با توجه به نتایج می‌توان گفت سامانه سیستم سه الکترودی ساخته شده دارای دقت بالایی در شناسایی فلزات سنگین در روغن‌های خوراکی است.

تاریخ های مقاله :

تاریخ دریافت: ۱۳۹۹/۱۲/۰۶

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۰/۰۲/۱۲

کلمات کلیدی:

سیستم سه الکترودی،

فلزات سنگین،

روغن خوراکی،

ولتاوتمتری چرخه‌ای.

DOI: 10.52547/fsct.18.116.293

* مسئول مکاتبات:

beheshti-b@srbiau.ac.ir

یک الگو تبدیل می‌کنند. با توجه به نوع کاربرد، آنالیز داده‌ها می‌تواند اطلاعات متنوعی را برای ما به وجود آورند [۵]. روش‌های الکتروتجزیه ای دارای تنوع گسترده‌ای بوده و متداول ترین این روشها در شکل نشان داده شده‌اند، این روش‌ها به دو دسته کلی، روش‌های مرزی و توده ای تقسیم می‌شوند که دسته اول کاربرد گسترده‌تری دارد. روش‌های مرزی مبتنی بر پدیده‌هایی است که در فصل مشترک بین سطح الکترود و لایه نازکی از محلول رویه می‌دهند. در مقابل، روش‌های توده ای بر اساس پدیده‌هایی است که در توده محلول رخ می‌دهد. روش‌های مرزی را می‌توان به دو دسته اصلی ایستا و پوپیا تقسیم نمود. این تقسیم بندهی حاکی از آن است که سلول‌های الکتروشیمیائی در غیاب با حضور جریان کار می‌کنند [۶]. روش‌های ایستا که مشتمل بر اندازه گیری‌های پتانسیومتری است، به دلیل سرعت و گزینش پذیری‌شان دارای اهمیت خاصی می‌باشند. روش‌های مرزی پوپیا که در آنها جریان در سلول‌های الکتروشیمیائی نقش اصلی دارد، به چند زیر گروه تقسیم می‌شوند. در روش‌های آمپرمتری، دلتامتری و کولومتری با پتانسیل ایستایی، پتانسیل سلول کنترل شده و سایر متغیرها اندازه گیری می‌شوند. در روش‌های پوپیای جریان ثابت، جریان در سلول ثابت نگه داشته می‌شود [۷].

در حسگرهای آمپرومتری با ثبت جریان عبوری از پیل در یک پتانسیل ثابت اعمال شده اندازه گیری می‌شوند. حسگرهای هدایت سنجی یا ولتاومنتری وابسته به تغییرات هایت الکتریکی یک فیلم یا یک حجم از ماده که هدایت آن تحت تاثیر گونه مورد تجزیه تجزیه می‌باشد، است. در واقع حسگر هدایت گونه مورد تجزیه را اندازه گیری می‌کند. در طراحی سیستم‌های سه الکتروودی می‌توان از حسگرهای الکتروشیمیائی مانند سنسورهای رسانا سنج [۸]، سنسورهای نوری [۹]، سنسورهای پیزوالکتریک نیز استفاده نمود. استفاده از روغن‌های گیاهی در تولیدات غذایی جایگزین مناسب برای روغن‌های حیوانی محسوب می‌شود زیرا اسیدهای چرب غیراشباع کمتری نسبت به روغن‌های حیوانی دارند [۱۰]. روغن‌های گیاهی حاصل چربی استخراج شده از گیاهان هستند که به صورت جامد یا مایع تولید می‌شوند. کاربرد اصلی این روغن‌ها در پختوپیز است و تا حدودی نیز در صنایع مربوط به تولید سوخت و وسائل بهداشتی و آرایشی استفاده

۱- مقدمه

امروزه ساخت حسگرهایی که فقط یک گونه خاص پاسخ دهنده موردن توجه قرار گرفته است. اما در عمل پاسخ یک حسگر می‌تواند ناشی از گونه‌های مزاحم موجود در محلول‌های واقعی نیز قرار گیرد. از طرف دیگر آنالیز همزمان گونه‌ها نیز از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد. روشی که سال‌های اخیر توجه پژوهشگران بسیاری را به خود جلب کرده است استفاده از آرایه ای از حسگرهای است [۱]. استفاده از چندین حسگر نسبت به یک حسگر مجزا مزایایی زیادی دارد. آرایه‌هایی از حسگرها به جای یک داده، داده‌های چند بعدی را برای هر نمونه به وجود آورده و اطلاعات بیشتری تولید کرده و گونه‌های مزاحم را تشخیص می‌دهد [۲]. حسگرهایی که تا کنون در این سیستم‌ها استفاده شده‌اند شامل حسگرهای ولتاومنتری، پتانسیومتری، اسپکتروسکوپی و فلئوروسانس می‌باشد. وقتی این آرایه‌ها برای تشخیص گونه‌های در محیط‌های مایع استفاده شوند به آن بینی الکترونیک و وقتی برای محیط‌های مایع استفاده شوند به آن زبان الکترونیک نامیده می‌شوند [۳]. اولين سیستم اندازه گیری در نمونه‌های مایع در سال ۱۹۹۰ توسط توکو که به حسگرهای چشمی معروف بوده ساخته شد که بعدها نام زبان الکترونیکی را به خود گرفت. از این سیستم‌ها می‌توان در کنترل کیفیت نمونه‌های مختلف، اندازه گیری گونه‌های مختلف زیست محیطی و آنالیزهای درمانی استفاده نمود. از مزایای سیستم‌های سه الکتروودی قیمت پایین، دسترسی راحت و سرعت بالای آن‌ها در مقابل سیستم‌های کروماتوگرافی و اسپکتروسکوپی است. همچنین این سیستم‌ها نیاز به حجم کمتری از نمونه دارد. باری کاربردهای کمی باید تعداد حسگرها حداقل به اندازه تعداد یون‌های مورد نظر باشد [۴].

مکانیسم عملکرد سیستم‌های سه الکتروودی بدین صورت است که در سطوح عمل کننده، حسگرهایی برای شناسایی مواد آلی و غیرآلی در نمونه‌های مختلف وجود دارد. این حسگرها از پوشش‌های حساس‌آلی برای آنالیز گونه‌ها در نمونه تشكیل شده‌اند. در این قسمت از یک مبدل که تبدیل پاسخ غشا را به سیگنال قابل اندازه گیری بر عهده دارد، استفاده می‌گردد. در قسمت ادراکی، سیستم‌های کامپیوتراً داده‌های حسگرها را به

تحقیق فلزات سنگین موجود در روغن‌های خوراکی با دقت بالا توسط آرایه‌ای از الکترودها و در قالب سامانه سه الکترودی شناسایی خواهد شد.

۲- مواد و روش ها

۱-۲- سیستم سه الکترودی

سیستم بکار رفته در روش‌های الکتروشیمیایی سیستم سه الکترودی است که در آن الکترود طلا به عنوان کار، از پلاتین به عنوان الکترود کمکی و کالومل اثبات به عنوان الکترود مرجع بکار گرفته می‌شود. اختلاف پتانسیل بین الکترود کار و الکترود مرجع برقرار می‌شود و شدت جریان بین الکترود کار و الکترود کمکی خوانده می‌شود. از حمام اولتراسونیک جهت همگن کردن محلول‌ها و همچنین به منظور زدایش مواد باقی مانده روی سطح الکترود کار استفاده شد [۱۶].

در این مطالعه تمامی اندازه‌گیری‌های الکتروشیمیایی با استفاده از روش ولتاوری چرخه ای (CV) با دستگاه potentiostat/galvanostat متصصل به کامپیوتر انجام شد. تست‌ها در دمای محیط 25°C و با $1.0\text{ mM K3Fe(CN)}_6/0.1\text{ M KCl}$ solution صورت گرفت. روش CV در محدوده پتانسیل $-0.2/\text{Ta}^{+0.7}$ ولت با سرعت روش 50 mVs^{-1} انجام گرفت. همچنین سامانه سه الکترودی متداول شامل الکترود کاری (مغز مداد گرافیتی اصلاح نشده، Glassy Carbon و Screen Printed)، سیم پلاتین به عنوان الکترود کمکی و Ag/AgCl به عنوان الکترود مرجع برای اندازه‌گیری‌های الکتروشیمیایی استفاده شد. در شکل (۱) شماتیک سامانه سه الکترودی آورده شده است.

می‌شوند. پرمصرف‌ترین انواع این روغن‌ها نیز شامل روغن نخل، سویا، کانولا و تخمه آفتاب‌گردان است [۱۱].

برخی فلزات به علت داشتن وزن اتمی بالا (نیروی ثقل مخصوص بیش تر از ۵ گرم بر سانتی‌مترمکعب) فلزات سنگین نامیده می‌شوند. حدود ۹۶ فلز در طبیعت در این گروه قرار می‌گیرند و در مورد برخی از آن‌ها اطلاعات سمشناسی کافی نیست. براین اساس فلزات مس تا بیسموت در جدول تناوبی به عنوان فلزات سنگین تعریف شده‌اند. در جدول تناوبی به فلزات گروه ۳ تا ۱۶ فلزات سنگین گویند [۱۲]. حضور فلزات در روغن‌های گیاهی بستگی به عوامل بسیاری دارد [۱۳]. همچنین ممکن است فلزات سنگین در طول فرایند تولید (با پردازش اقداماتی مانند رنگبری تصفیه و بی‌بو کردن) و یا با آسودگی تجهیزات فرآوری فلزی ایجاد شوند و در نتیجه در روغن به حالت معلق موجود باشند [۱۴]. سطوح بسیار ناچیزی از این یون‌های فلزی اثرات سوء بر رنگ و بو دارند. حضور فلزات در روغن تصفیه شده نهایی نامطلوب است زیرا فلزات می‌توانند موجب تخریب اکسیداتیو روغن و کاهش ماندگاری روغن شوند [۱۳]. سیستم‌های سه الکترودی از آرایه‌ای از حسگرهای شیمیایی تشکیل شده است و در مقایسه به دیگر روش‌های تحلیل بسیار سریع، ساده و برخط اندازه‌گیری‌ها را انجام می‌دهد [۱۵]. دهه‌های اخیر استفاده از روش‌های سریع، انتخاب‌پذیر و حساس جهت کاربرد در امنیت غذایی و سلامت عموم توسعه یافته است و صنایع در حال پیشرفت روش‌هایی با پاسخ‌دهی بالا و هزینه ساخت کم هستند. بنابراین نیاز است تا ابزاری الکترونیک جهت ارزیابی مواد غذایی با دقت و پاسخ بالا استفاده شوند. در این

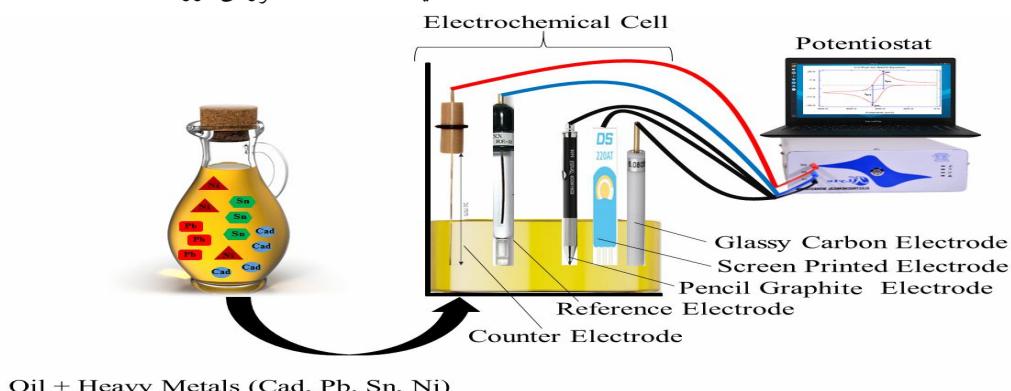


Fig 1 Schematic of three electrode system for detection of heavy metals in olive oil

شد و سپس ۵ میلی لیتر اسید نیتریک غلیظ و ۲ میلی لیتر آب اکسیژنه بر روی آن افزوده شد. در جدول (۱) روغن زیتون با مقادیر فلزات سنگین در آن نشان داده شده است. در ادامه نمونه ها جهت انجام عمل هضم داخل مایکروویو قرار گرفتند. عملیات هضم فلزات سنگین در روغن در سه مرحله در فشار ثابت ۵۰ با اعمال شیب دمایی و افزایش توان برخورد امواج مایکروویو انجام شد و دما از ۵۰ درجه در مرحله اول به ۱۷۵ درجه در مرحله سوم افزایش یافت. پس از پایان عملیات هضم، محلول حاصل در داخل لوله های فالکون اسیدواش شده وارد گردید و یک میلی لیتر از آن به داخل میکروتیوب وارد گردید و جهت سنجش میزان فلز سنگین توسط سامانه سه الکترودی آماده شد. نمونه های روغن خوراکی شامل سه نوع فلز سنگین در روغن زیتون می باشد (جدول ۱). روغن خوراکی در دمای ۲۰ درجه سلسیوس که در مکانی تاریک و با هوای مناسب جهت جلوگیری از یخ زدن قرار گرفتند تا برای آزمایشات استفاده شوند.

Table 1 Olive oil and heavy metals sample preparation

Heavy Metals/Oil	Cd	Pb	Sn	Ni
Olive	0.05	0.05	0.05	0.05
	0.1	0.1	0.1	0.1
	0.25	0.25	0.25	0.25

۵-۲- تحلیل مؤلفه های اصلی (PCA)

روش تحلیل مؤلفه های اصلی (Principal component analysis) روشی آماری است که از انتقال متعامد برای تبدیل مجموعه ای از متغیرهای مشاهده شده دارای همبستگی به مجموعه ای از متغیرهای غیرهمسنته خطی که اجزای اصلی هستند، استفاده می کند. این تبدیل بدین صورت است که اولین جزء اصلی دارای واریانس بالایی است و سپس اجزای دیگر نیز دارای واریانس بالا و البته با محدودیت می باشند که در تعامل با اجزای پیشین می باشند. روش PCA حساس و با دقت بالا در یافتن متغیرهای اصلی می باشد. PCA از جمله روش های متداول در تجزیه و تحلیل داده ها و کاهش ابعاد در سیستم های چند متغیره است [۱۷].

۶-۲- آماده سازی محلول های استاندارد استفاده شده در آزمایش

جهت تهیه محلول های استاندارد، از محلول کادمیم، سرب، قلع و نیکل استوک خالص با غلظت ۱۰۰۰ شرکت سیگما آldrیج آلمان استفاده شد. محلول های ۰/۰۵، ۰/۰۱ و ۰/۲۵ ppm از رقیق سازی حجم مناسبی از محلول استوک در بالن ژوژه های اسیدواش شده تهیه گردید. محلول های استاندارد کاری تمام فلزات در دامنه غلظت مشابه با رقیق سازی مناسب محلول استوک ppm ۱۰۰۰ (سیگما آldrیج) تهیه گردید.

۶-۳- فلزات سنگین در نمونه های روغن

جهت انجام مطالعه، روغن زیتون خالص از فروشگاهی خردباری شد و تا زمان انجام آزمایش در جعبه ای بدون نور و در مکان مناسب و خنک نگهداری شد. به منظور استخراج عناصر از نمونه ها، ۰/۰۵ گرم نمونه روغن هموزن درون ظرف تفلونی مخصوص مایکروویو ریخته شد. ظرف حاوی نمونه در زیر هود قرار داده شوند.

۶-۴- تحلیل و آماده سازی داده ها

پاسخ های آرایه ای متشکل از چند حسگر حاوی مقدار قابل ملاحظه ای اطلاعات است. معمولاً از مجموعه این پاسخ ها چندین ویژگی برای تحلیل مزه استخراج می شود. هدف، تبدیل داده های اندازه گیری شده به مشخصاتی از آنالیت مورد بررسی است. این مشخصات می توانند نوع، مقدار یا خاصیتی از آنالیت باشد [۲]. با پردازش داده ها در چند مرحله می توان تنباطی بین ویژگی های آنالیت و الگوهای ثبت شده برقرار کرد. ابتدا، یک مرحله پیش پردازش بر داده ها اعمال می شود. پس از آن طی یک مرحله استخراج ویژگی، ابعاد داده ها کاهش داده می شود. با دسته بندی داده ها در فضای ویژگی می توان نوع آنالیت را تشخیص داد [۱۶].

۳- نتایج و بحث

بر اساس نتایج PCA، تمایزات معنی داری بین ۴ نوع فلز سنگین و غلطت های متفاوت آن در روغن زیتون نیز مشاهده گردید. شکل (۲) نتایج PC کتروود PG در تمایز بین فلزات سنگین و غلطت های مختلف آن در روغن زیتون را نشان می دهد. دو مولفه PC1 و PC2 به ترتیب توانایی تمایز ۸۵٪ و ۱۳٪ بین فلزات سنگین و در مجموع ۹۸٪ واریانس کل داده ها را نشان می دهد. با توجه به نتایج، گروه کترول به خوبی از دیگر گروه های فلزاتی جدا شده است. همچنین گروه فلزاتی قلع و نیکل نیز کاملا از هم تمایز شده است اما سرب و کادمیم در برخی نقاط مانند کادمیم ۰/۰۵ و سرب ۰/۰۵ با یکدیگر تماس داشته و در مرز همپوشانی قرار دارند.

شکل (۳)، نتایج PC کتروود SP را در روغن زیتون نشان می دهد. دو مولفه PC1 و PC2 دارای واریانس ۷۶٪ و ۲۳٪ داده را شامل شده و در مجموع ۹۹٪ واریانس کل داده ها را شامل می شود. کتروود SP توانای مناسبی در تشخیص و تمایز بین گروه های فلزات سنگین در روغن زیتون از خود نشان نداده است. تمامی گروه های فلزات سنگین دارای اندکی همپوشانی بوده اما توانسته است گروه کترول را به خوبی از میان گروه های فلزاتی تمایز کند.

همچنین در شکل (۴)، دو مولفه PC1 و PC2 به ترتیب ۸۹٪ و ۷٪ در مجموع ۹۶٪ واریانس داده را شامل شده و کتروود GC می تواند به خوبی فلزات را در روغن زیتون از هم تمایز می کند. کتروود GC نیز به خوبی تمام گروه های فلزات سنگین را از گروه کترول و فلزات مختلف از هم شناسایی می کند و توانسته است با دقت بالا حتی غلطت های مختلف را نیز از هم تمایز کند.

کربن برای کتروود گلسی کربن بستری است که شکل پذیر، قابل نفوذ، فشرده و در عین حال متخلخل باشد. کتروود گلسی کربن بدليل خصوصیات رسانایی و مکانیکی خوب، خواص الکتروکاتالیتیکی مناسبی را نسبت به کتروود PG نشان داده است. مطالعه نتایج منتشر شده نشان میدهد که تجمع کربن ها بر روی کتروود گلسی کربن اکثر اوقات باعث افزایش جریان ردودکس و همچنین کاهش پتانسیل در الکتروکاتالیز خیلی از

۶-۲- ماشین بردار پشتیبان (SVM)

روش ماشین بردار پشتیبان (support vector machine) در سال ۱۹۹۸ معرفی گردید. هدف این روش یافتن صفحه ای بهینه با کمترین فاصله بین تمام داده ها و نقاط می باشد [۱۸]. الگوریتم آموزشی SVM، مدلی جدید به دسته داده ها نسبت می دهد یا داده ها را به یک طبقه بندی خطی مرزی غیر احتمالی تبدیل می کند. نتیجه این مدل، نمایشی از داده ها در فضای چند بعدی است که داده ها در طبقه هایی تقسیم بندی شده اند و توسط یک صفحه محدوده های بین داده ها مشخص می گردد. داده های جدید نیز در همان فضا قرار می گیرند و بر اساس محدوده های که روی صفحه قرار می گیرند، طبقه بندی آن ها پیش بینی می شود [۱۷ و ۱۸].

۷-۲- حداقل مربعات جزئی (PLS)

حداقل مربعات جزئی (partial least square) یکی از قدرتمندترین تکنیک ها در حوزه کمومتریکس، تحلیل فاکتور می باشد. تحلیل فاکتور روشنی چند متغیره است که با استفاده از کاهش ابعاد داده ها و حداقل تعداد بردارهای عمود بر هم، اطلاعات مهم و کاربردی ارائه می دهد. از جمله روش های تحلیل فاکتور روش حداقل مربعات جزئی می باشد. فاکتور یا اجزاء اصلی ترکیبی خطی از متغیرهای اصلی موجود در ماتریس ها می باشد و می توان بجای ماتریس $J \times I$ ، متغیرهای آن را به صورت ترکیب خطی از F فاکتور تعریف نمود و در نهایت متغیرهای جدید برای ماتریس تعريف می گردد [۱۹].

روش PLS به جای یافتن صفحه ای از ماتریس واریانس ها بین پاسخ ها و متغیرهای غیر مستقل، بین اجزای اصلی ارتباط برقرار می کند. این روش مدل رگرسیون خطی بین متغیرهای پیش بینی شده و متغیرهای مشاهده شده را در فضای جدید ایجاد می کند. در نهایت مدل رگرسیونی جدید بین نتایج متغیرهای رودی و خروجی در طی یک فرآیند مدل سازی PLS ساخته می شود. عملکرد مدل با استفاده از ضرایب R^2 و RMSE مشخص می گردد [۱۹ و ۲۰]. کلیه تحلیل های PCA، SVM و PLS با استفاده از نرم افزار (CAMO AS, Trondheim, Norway) Unscrambler x10.4 انجام شد.

تشخیص روغن زیتون آلوده به فلزات سنگین...

در تحقیقی Haddi و همکاران (۲۰۱۳) طبقه بنده روغن زیتون مراکشی توسط آرایه زبان و بینی الکترونیک را انجام دادند. در این تحقیق از سامانه ترکیبی بینی و زبان الکترونیک جهت بررسی و تشخیص ۵ نوع متفاوت روغن زیتونی مراکشی استفاده شد. نتایج تحلیل مولفه اصلی، همپوشانی اندکی را در پاسخ های آرایه های حاصل از بینی الکترونیک نشان داد و با توجه به نتایج آن می توان گفت بینی الکترونیک به تنها بی کارایی نداشته و می توان از ترکیب زبان و بینی الکترونیک در کنار هم جهت تشخیص استفاده نمود. همچنین نتایج PCA و CA منجر به انتخاب متغیرهای بهینه و افزایش عملکرد طبقه بنده گردید. همچنین روش های نظارت شده ای مانند SVM در ترکیب با پاسخ های آرایه بینی و زبان الکترونیک می تواند روغن زیتون را بر اساس منطقه جغرافیایی طبقه بنده نماید. PCA توانست ۹۰٪ واریانس داده ها را در مجموع شناسایی کرده و طبقه بنده نماید [۲۵].

در تحقیقی Oliver و همکاران (۲۰۰۹) یک زبان الکترونیک مبتنی بر ولتاوتمتری چرخه ای با میکروالکترود پلاتین جهت تشخیص روغن های خوراکی بر اساس منطقه جغرافیایی انجام دادند. بر اساس نتایج ولتاگرام ها، روش PCA و K-NN طبقه بنده استفاده شد و نتایج نشان داد که می توان به راحتی توسط زبان الکترونیک روغن ها با مناطق مختلف جغرافیایی مختلف را طبقه بنده نمود [۲۶].

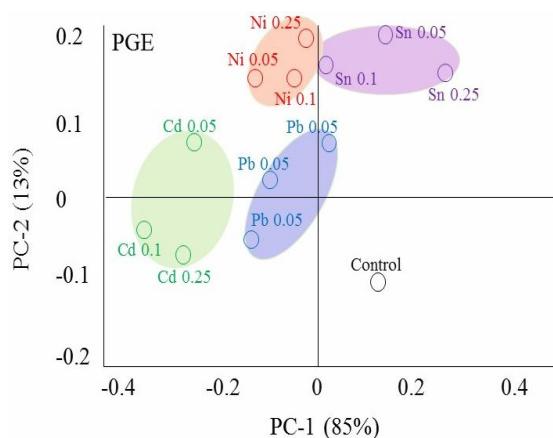


Fig 2 Classification with PCA for detection of heavy metals by PG electrodes in olive oil

آنالیت ها می شود. همچنین از ویژگی های مهم لوله های کربنی همراه با مایعات یونی نسبت سطح به حجم بالای آنهاست لذا اصلاح سطح الکترود گلسی کردن با کربن بر مساحت سطح و در نتیجه هدایت آنها می افزاید [۲۱].

نتایج نشان می دهد که روش PCA میتواند بین انواع مختلفی از روغن ها تمایز ایجاد نماید و با سرعت و دقت عمل می تواند برای طبقه بنده استفاده گردد. نتایج نشان داد که این روش دارای حساسیت بالایی نسبت به فلزات سنگین است. روش PCA توسط محققان بسیاری جهت بررسی فلزات سنگین استفاده شده است. همچنین مطالعات نشان می دهد که به دلایل نوع خاک، شرایط هواشناسی، نحوه برداشت و شرایط انبارداری به راحتی نمی توان انواع روغن ها را طبقه بنده نمود [۱۹ و ۲۰].

Ceto و همکاران (۲۰۲۰) مطالعه ای روی بررسی میزان مواد شوینده در چای، شیر و آب میوه توسط زبان الکترونیک ولتاوتمتری با الکترودهای الکترودهای فلز نجیب، پلاتین، طلا، ایریدیوم، پالادیوم و روڈیوم مطالعه انجام دادند. نتایج آن ها نیز نشان داد که PCA توانست به خوبی و در مجموع ۹۵ درصد واریانس بین داده ها را پوشش دهد تشخیص داده و همچنین PLS نیز با دقت ۹۷ درصد پیش بینی داده ها را انجام داد [۲۲].

Tian و همکاران (۲۰۱۹) توسط آرایه زبان الکترونیک و روشن ولتاوتمتری با الکترودهای الکترودهای فلزی نجیب مانند پلاتین، طلا، پالادیوم، تیتانیوم، نیکل میزان تقلب در چای چینی را طبقه بنده نمودند. همچنین در این تحقیق PCA توانست ۸۷ درصد واریانس بین داده ها را پوشش داده و کار تشخیص را انجام دهد [۲۳].

Men و همکاران (۲۰۱۴) از زبان الکترونیک ولتاوتمتری جهت طبقه بنده ۵ مدل از روغن های خوراکی استفاده کردند. این سیستم شامل ترکیب سه الکترود طلا، پلاتینیوم و کالومل اشباع است. با استفاده از ولتاوتمتری چرخه ای، ۵ نوع متفاوت از روغن های خوراکی (بادام زمینی، سویا، ذرت، کنجد و آفتابگردان) شناسایی شد. داده های حاصل از شناسایی روغن ها توسط روش PCA و HCA و FA بررسی شدند. نتایج نشان داد که روش PCA در مجموع ۷۸٪ داده ها را تشخیص داده و زبان الکترونیک ولتاوتمتری حاصل توانسته است به خوبی ۵ نوع مختلف روغن را از هم طبقه بنده نماید [۲۴].

می توان توسط این توابع بهترین طبقه بندی با بالاترین میزان دقیقت در طبقه بندی را انجام داد. همچنین در الکترود SP، نیز بهترین روش طبقه بندی توسط SVM، روشن NU-SVM و SVM، روشن طبقه بندی شعاعی و سیگموئید با بالاترین دقیقت در داده آموزش و انتبارسنگی توانستند طبقه بندی فلزات سنگین و غلظت های مختلف آن را انجام داد. در نهایت الکترود GC، توانست توسط روشن C-SVM و با کمک هر چهار نوع تابع خطی، چند جمله ای، پایه شعاعی و سیگموئید طبقه بندی فلزات سنگین و غلظت های مختلف آن را انجام دهد. Haddi و همکاران (۲۰۱۳) مطالعه ای روی طبقه بندی روغن زیتون مراکشی توسط آرایه زبان و بینی الکترونیک انجام دادند. در این تحقیق از سامانه ترکیبی بینی و زبان الکترونیک جهت بررسی و تشخیص ۵ نوع متفاوت روغن زیتونی مراکشی استفاده شد. نتایج تحلیل مولفه اصلی، همپوشانی اندرکی را در پاسخ های آرایه های حاصل از بینی الکترونیک نشان داد و با توجه به نتایج آن می توان گفت بینی الکترونیک به تنها ی کارایی نداشت و می توان از ترکیب زبان و بینی الکترونیک در کنار هم جهت تشخیص استفاده نمود. همچنین نتایج PCA و CA منجر به انتخاب متغیرهای بهینه و افزایش عملکرد طبقه بندی گردید. همچنین روشن های نظرات شده ای مانند SVM در ترکیب با پاسخ های آرایه بینی و زبان الکترونیک می توانند روغن زیتون را بر اساس منطقه جغرافیایی طبقه بندی نمایند. PCA توانست ۹۰/۹٪ واریانس داده ها را در مجموع شناسایی کرده و طبقه بندی نماید [۲۵].

غلظت های مختلف فلزات سنگین در روغن خوراکی سویا توسط سامانه سه الکترودی و روشن PLS پیش بینی شد. در شکل (۵ تا ۷)، وزن های پیش بینی شده در مقابل با وزن های واقعی نشان داده شده است. نتایج تحقیق، نشان داد که روشن PLS می تواند داده های حاصل از الکترود PG، SP و GC را با دقیقت های به ترتیب ۸۹/۹۲، ۹۸/۶۴ و ۸۹/۲۳٪ پیش بینی کند.

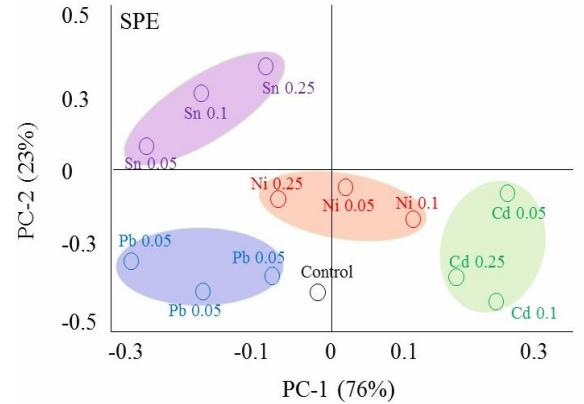


Fig 3 Classification with PCA for detection of heavy metals by SP electrodes in olive oil

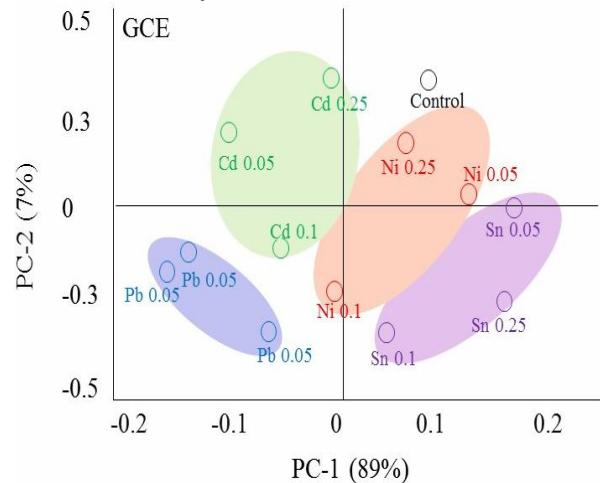




Fig 4 Classification with PCA for detection of heavy metals by GC electrodes in olive oil

جهت طبقه بندی فلزات سنگین و غلظت های مختلف آن توسط الکترودهای GC، SP و PG از روشن SVM و از دو روشن C-Nu-SVM و Nu-SVM استفاده گردیده است. پارامترهای SVM و C-Nu-SVM با سعی و خطأ و از طریق به حداقل رساندن اعتبارسنگی شدنند. چهار تابع کرنل خطی، چند جمله ای، پایه شعاعی و سیگموئید استفاده شده است. در جدول (۲)، نتایج طبقه بندی با SVM آورده شده است.

در بین تمامی روشن ها، توسط الکترود GC بهترین طبقه بندی صورت گرفت. در الکترود PG، روشن C-SVM و توابع چند جمله ای، پایه ضعاعی و سیگموئید دارای بهترین نتایج بوده و

Table 2 Results and comparison of Nu-SVM and C-SVM models subjected to the kernel functions

	Kernel function	C-SVM				Nu-SVM			
		c	γ	Train	Validation	Nu	γ	Train	Validation
PGE	Linear	0.11	-	80	80.35	0.33	-	100	85
	Polynomial	0.12	0.01	100	80.35	0.33	0.03	100	100
	Radial Basis	0.11	0.01	100	80.35	0.33	0.03	100	100
	Sigmoid	0.05	0.34	100	80.35	0.05	0.60	100	85
SPE	Linear	0.12	-	80	100	0.22	-	80.35	70
	Polynomial	0.11	0.05	80	100	0.55	0.01	80.35	70
	Radial Basis	1.66	0.09	80	100	0.22	0.04	80.35	70
	Sigmoid	1.66	0.05	80	100	0.22	0.05	80.35	70
GCE	Linear	0.05	-	85	100	0.33	-	100	80
	Polynomial	0.01	0.09	100	100	0.33	0.05	100	80
	Radial Basis	0.05	0.09	100	100	0.22	0.03	100	80
	Sigmoid	0.05	0.03	100	100	0.33	0.01	100	80

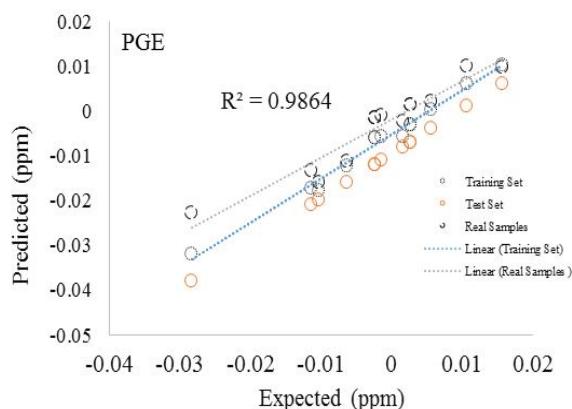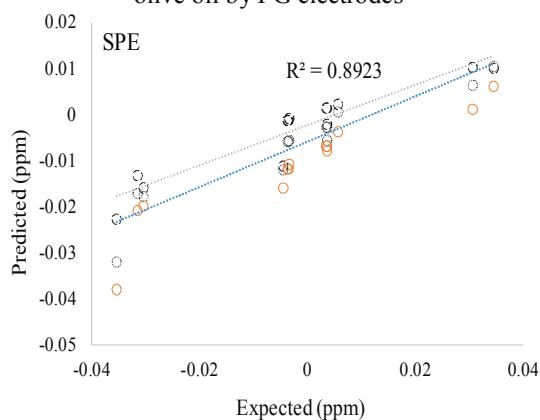**Fig 5** PLS results for detection of heavy metals in olive oil by PG electrodes**Fig 6** PLS results for detection of heavy metals in olive oil by SP electrodes

عملکرد مدل PLS بری پیش بینی با استفاده از ضرایب R^2 مشخص می گردد و می توان گفت که با روش PLS می توان فلزات سنگین در روغن زیتون را توسط الکترودهای PG و SP پیش بینی نمود. Men و همکاران (۲۰۱۴) تحقیقی روی کاربرد زبان و بینی الکترونیک در تشخیص روغن های خوراکی ترکیبی انجام دادند. با توجه به مصرف روز افزون روغن های خوراکی و افزودنی های بیشماری که به آن اضافه می شود، در این تحقیق از زبان الکترونیک در ترکیب با دیتافیوژن دو نوع روغن تاریخ گذشته را ازیکدیگر تشخیص دادند. با استفاده از روش تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی و حداقل مربعات جزئی نتایج نشان داد که دو فناوری زبان و بینی الکترونیک می توانند در تشخیص تقلب و افزودنی های روغن های خوراکی استفاده شود. همچنین PCA توانست در مجموع ۸۵٪ واریانس بین داده ها را پوشش داده و PLS نیز با دقت ۹۶٪ توانست پیش بینی داده های حاصل از ولتاگرام ها را انجام دهد [۲۴]. Polshin (۲۰۱۰) و همکاران (۲۰۱۰) توسط زبان الکترونیک و ولتامتری و الکترودهای صفحات پلاتین، الکترودهای کربنی، پلیپروپیلن، فنالوسیانین ها توانستند مقادیر لیگتروسید را در ماء الشعیر بررسی نمایند. در این تحقیق روش PLS توانست با دقت ۹۰ درصد داده های حاصل از ولتاگرام را پیش بینی نماید [۲۷].

- potentiometric e-tongue. *Journal of Food Composition and Analysis*, 75, pp.75-80.
- [2] Kaushal, P. and Mudhalwadkar, R., 2020. Stationary wavelet singular entropy based electronic tongue for classification of milk. *Transactions of the Institute of Measurement and Control*, 42(4), pp.870-879.
- [3] Geană, E.I., Ciucure, C.T., Artem, V. and Apetrei, C., 2020. Wine varietal discrimination and classification using a voltammetric sensor array based on modified screen-printed electrodes in conjunction with chemometric analysis. *Microchemical Journal*, p.105451.
- [4] Elamine, Y., Inácio, P.M., Lyoussi, B., Anjos, O., Estevinho, L.M., da Graça Miguel, M. and Gomes, H.L., 2019. Insight into the sensing mechanism of an impedance based electronic tongue for honey botanic origin discrimination. *Sensors and Actuators B: Chemical*, 285, pp.24-33.
- [5] de Morais, T.C.B., Rodrigues, D.R., Souto, U.T.D.C.P. and Lemos, S.G., 2019. A simple voltammetric electronic tongue for the analysis of coffee adulterations. *Food chemistry*, 273, pp.31-38.
- [6] Pérez-Ràfols, C., Serrano, N., Ariño, C., Esteban, M. and Díaz-Cruz, J.M., 2019. Voltammetric electronic tongues in food analysis. *Sensors*, 19(19), p.4261.
- [7] Pauliuc, D., Dranca, F. and Oroian, M., 2020. Raspberry, Rape, Thyme, Sunflower and Mint Honeys Authentication Using Voltammetric Tongue. *Sensors*, 20(9), p.2565.
- [8] Cabral, F.P., Bergamo, B.B., Dantas, C.A., Riul Jr, A. and Giacometti, J.A., 2009. Impedance e-tongue instrument for rapid liquid assessment. *Review of Scientific Instruments*, 80(2), p.026107.
- [9] Sánchez, J. and del Valle, M., 2001. A New Potentiometric Photocurable Membrane Selective to Anionic Surfactants. *Electroanalysis: An International Journal Devoted to Fundamental and Practical Aspects of Electroanalysis*, 13(6), pp.471-476.
- [10] Szczewski, P., Frankowski, M., ZiołFrankowska, A., Siepak, J., Szczewski, T. and Piotrowski, P., 2016. A comparative study of the content of heavy metals in oils: linseed oil, rapeseed oil and soybean oil in technological production processes. *Archives of Environmental Protection*, 42(3), pp.37-40.

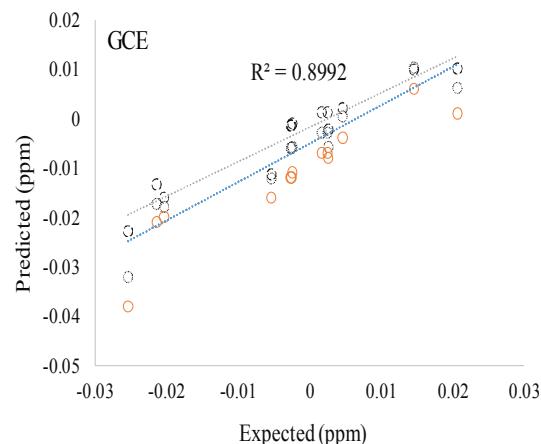


Fig 7 PLS results for detection of heavy metals in olive oil by GC electrodes

۴- نتیجه گیری

الکتروشیمی شامل تأثیر شیمی و الکتریسیته و اندازه‌گیری کیت‌های الکتریکی مانند جریان، پتانسیل و ارتباط آنها با پارامترهای شیمیابی است. کاربرد روش‌های الکتروشیمیابی مبنی بر در واکنش‌های الکترودی و عوامل الکتریکی سطح مشترک محلول و الکترود است و به دلیل انتخاب پذیری، حساسیت بالا، هزینه کم، سرعت بالا، صحت و دقت بالا و سهولت انجام، از این روش‌ها به عنوان انتخابی‌ترین روش‌های تجزیه‌ای برای اندازه‌گیری کمی و کیفی استفاده می‌شود. در تحقیق حاضر از یک سامانه سه الکترودی با سه الکترود SP, PG و GC جهت شناسایی فلزات سنگین در روغن‌های خوراکی استفاده شد. با توجه به نتایج می‌توان گفت توسط سامانه مذکور در ترکیب با روش‌های طبقه‌بندی و پیش‌بینی کمومتریک می‌توان به صورت دقیق کار شناسایی، طبقه‌بندی و پیش‌بینی را انجام داد. همچنین می‌توان گفت در صنایع و از ترکیب سامانه سه الکترودی با روش‌های کمومتریک می‌توان جهت تشخیص فلزات در روغن‌های خوراکی استفاده کرد و فلزات را در گروه‌های مربوطه طبقه‌بندی نمود و وجود آن‌ها را پیش‌بینی کرد.

۵- منابع

- [1] Semenov, V., Volkov, S., Khaydukova, M., Fedorov, A., Lisitsyna, I., Kirsanov, D. and Legin, A., 2019. Determination of three quality parameters in vegetable oils using

2020. Non-parametric partial least squares-discriminant analysis model based on sum of ranking difference algorithm for tea grade identification using electronic tongue data identify tea grade using e-tongue data. Sensors and Actuators B: Chemical, p.127924.
- [20] Baldo, M.A., Oliveri, P., Fabris, S., Malegori, C. and Daniele, S., 2019. Fast determination of extra-virgin olive oil acidity by voltammetry and Partial Least Squares regression. *Analytica chimica acta*, 1056, pp.7-15.
- [21] Tahri, K., Duarte, A. A., Carvalho, G., Ribeiro, P. A., da Silva, M. G., Mendes, D., ... & Bouchikhi, B. 2018. Distinguishment, identification and aroma compound quantification of Portuguese olive oils based on physicochemical attributes, HS-GC/MS analysis and voltammetric electronic tongue. *Journal of the Science of Food and Agriculture*, 98(2), 681-690.
- [22] Cetó, X., & Pérez, S. 2020. Voltammetric electronic tongue for vinegar fingerprinting. *Talanta*, 219, 121253.
- [23] Tian, X., Wang, J., Ma, Z., Li, M., & Wei, Z. 2019. Combination of an E-Nose and an E-Tongue for Adulteration Detection of Minced Mutton Mixed with Pork. *Journal of Food Quality*.
- [24] Men, H., Chen, D., Zhang, X., Liu, J., & Ning, K. 2014. Data fusion of electronic nose and electronic tongue for detection of mixed edible-oil. *Journal of Sensors*.
- [25] Haddi, Z., Alami, H., El Bari, N., Tounsi, M., Barhoumi, H., Maaref, A., ... & Bouchikhi, B. E. N. A. C. H. I. R. 2013. Electronic nose and tongue combination for improved classification of Moroccan virgin olive oil profiles. *Food Research International*, 54(2), 1488-1498.
- [26] Oliveri, P., Baldo, M. A., Daniele, S., & Forina, M. 2009. Development of a voltammetric electronic tongue for discrimination of edible oils. *Analytical and bioanalytical chemistry*, 395(4), 1135-1143.
- [27] Polshin, E., Rudnitskaya, A., Kirsanov, D., Legin, A., Saison, D., Delvaux, F., ... & Lammertyn, J. 2010. Electronic tongue as a screening tool for rapid analysis of beer. *Talanta*, 81(1-2), 88-94.
- [11] Rizwan, M., Ali, S., Abbas, F., Adrees, M., Zia-ur-Rehman, M., Farid, M., Gill, R.A. and Ali, B., 2017. Role of organic and inorganic amendments in alleviating heavy metal stress in oil seed crops. *Oil seed crops: yield and adaptations under environmental stress*, 12, pp.224-235.
- [12] Lajayer, B.A., Ghorbanpour, M. and Nikabadi, S., 2017. Heavy metals in contaminated environment: destiny of secondary metabolite biosynthesis, oxidative status and phytoextraction in medicinal plants. *Ecotoxicology and Environmental Safety*, 145, pp.377-390.
- [13] Pehlivan, E., Arslan, G., Gode, F., Altun, T. and Özcan, M.M., 2008. Determination of some inorganic metals in edible vegetable oils by inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy (ICP-AES). *Grasas y aceites*, 59(3), pp.239-244.
- [14] Lima, H.R.S., da Silva, J.S., de Oliveira Farias, E.A., Teixeira, P.R.S., Eiras, C. and Nunes, L.C.C., 2018. Electrochemical sensors and biosensors for the analysis of antineoplastic drugs. *Biosensors and Bioelectronics*, 108, pp.27-37.
- [15] Ahn, S.R., An, J.H., Jang, I.H., Na, W., Yang, H., Cho, K.H., Lee, S.H., Song, H.S., Jang, J. and Park, T.H., 2018. High-performance bioelectronic tongue using ligand binding domain T1R1 VFT for umami taste detection. *Biosensors and Bioelectronics*, 117, pp.628-636.
- [16] Wang, W. and Liu, Y., 2019. Electronic tongue for food sensory evaluation. In *Evaluation technologies for food quality* (pp. 23-36). Woodhead Publishing.
- [17] Oroian, M. and Ropciuc, S., 2019. Romanian honey authentication using voltammetric electronic tongue. Correlation of voltammetric data with physico-chemical parameters and phenolic compounds. *Computers and Electronics in Agriculture*, 157, pp.371-379.
- [18] Xu, M., Wang, J. and Zhu, L., 2019. The qualitative and quantitative assessment of tea quality based on E-nose, E-tongue and E-eye combined with chemometrics. *Food chemistry*, 289, pp.482-489.
- [19] Chen, X., Xu, Y., Meng, L., Chen, X., Yuan, L., Cai, Q., Shi, W. and Huang, G.,

Iranian Journal of Food Science and TechnologyHomepage: www.fsct.modares.ir**Scientific Research**

Detection of olive oil contaminated with heavy metals using a three-electrodes system based on the cyclic voltammetry

Kiani, H. ¹, Beheshti, B. ^{2*}, Borghei, A. M. ³, Rahmati, M. H. ⁴

1. Ph.D. student, Department of Biosystems Engineering, Faculty of Agricultural Sciences and Food Industry, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2. Assistant Professor, Department of Biosystems Engineering, Faculty of Agricultural Sciences and Food Industry, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3. Professor, Department of Biosystems Engineering, Faculty of Agricultural Sciences and Food Industry, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
4. Associate Professor, Department of Biosystem Mechanical Engineering, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.

ARTICLE INFO**ABSTRACT****Article History:**

Received 2021/02/24
Accepted 2021/05/02

Keywords:

Three Electrodes System,
Heavy Metals,
Edible Oil,
Cyclic Voltammetry.

DOI: [10.52547/fsct.18.116.293](https://doi.org/10.52547/fsct.18.116.293)

*Corresponding Author E-Mail:
beheshti-b@srbiau.ac.ir

Three electrodes system simulates the human tongue taste system and can be used to assess the quality of food. The sense of taste is one of the five senses and tongue recognizes certain molecules. In recent years, three electrode system with an array of electrodes has been used to identify various molecules. In this research, a three electrodes system is used based on voltammetric methods with three graphite electrodes (Pencil Graphite (PG)), Screen Printed (SP) and Glassy Carbon (GC) to identify heavy metals (cadmium, Lead, tin and nickel) in olive oil. Heavy metals are added to the edible oil in three concentrations of 0.05, 0.1 and 0.25 ppm and then the output of the device is classified by chemometric method. According to PCA results, the PG electrode contains 96% of the variance between the data in olive edible oils. Also, SP electrode contains 91% and GC contains 100% of the variance between the data in olive oil. The SVM method showed a high ability to classify heavy metals in edible oils. Also, The PLS method was also able to predict 99% of the data in olive oil for all electrodes. Finally, according to the results, it can be said that the built-in three electrode system has a high accuracy in identifying heavy metals in edible oils.